



3D-Ansicht der Aufspannvorrichtung:

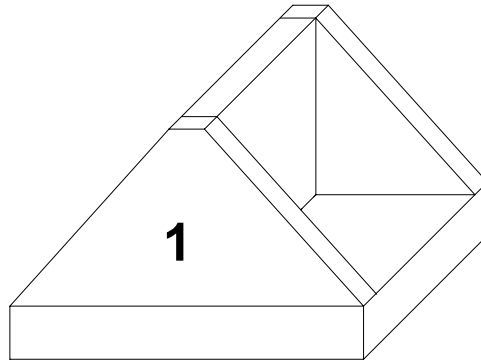

Maximale Belastungen der Schwinganlage mit obiger Aufspannvorrichtung:

Prüfart	Schärfegrad	Prüflingsgewicht	Bemerkungen
Schockprüfung	max. 50g / 11ms	max. 4kg	
Sinusförmige Vibration	max. 10g	max 10kg*	*nach Prüflings- abmessungen, Symmetrie, Schwerpunkt
Rauschprüfung	max 10geff, B=2kHz 5geff 2geff	max. 4kg max. 8kg max 10kg	*nach Prüflings- abmessungen, Symmetrie, Schwerpunkt

Draufsicht Aufspannvorrichtung:

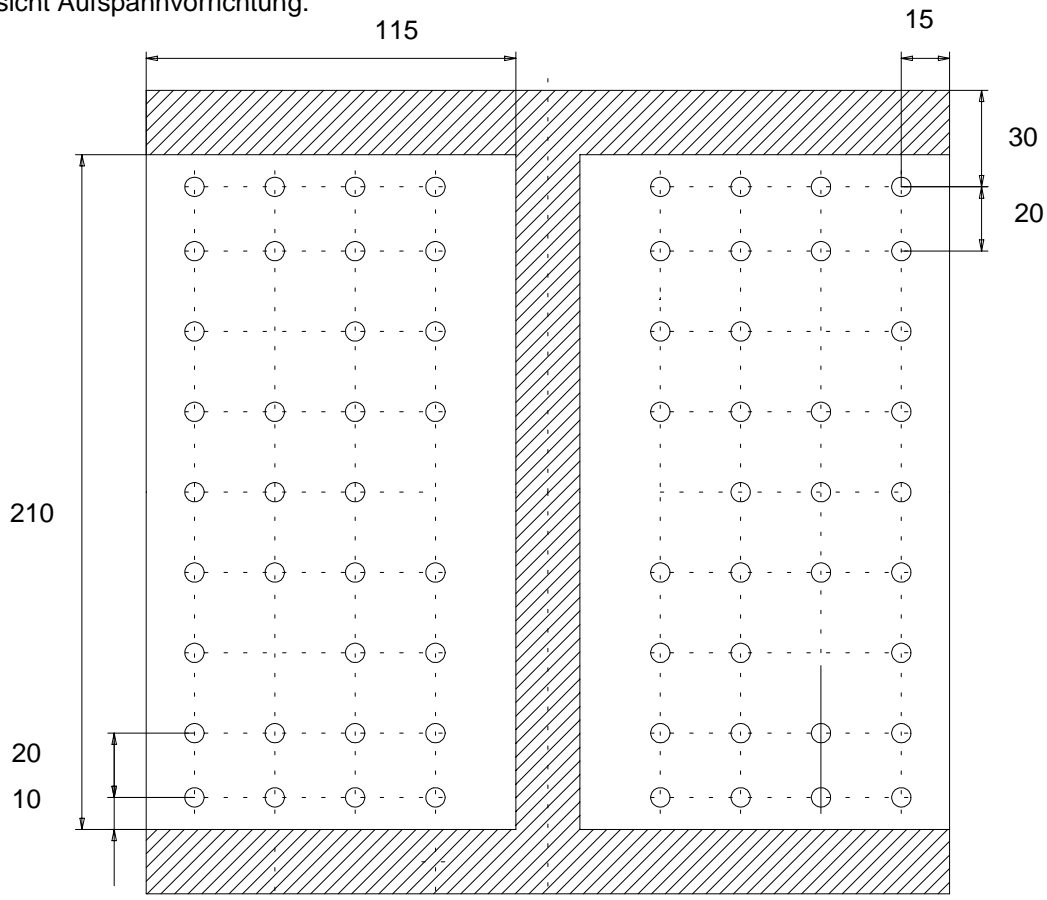

Alle Rastergewinde M6, alle nichtbemaßten Abstände betragen 25 mm (Raster 25mm x 25mm)

Seitenansicht Mittelteil:

